

2026年版

Wine

ワイン向け測定器カタログ

ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社



〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6

エム・ベイポイント幕張14F

TEL : 043-216-2601 FAX : 043-216-2602

E-mail : sales@hanna.co.jp

「ハンナジャパン」で検索

2026.2

本カタログの表示価格はすべて税抜です。

ハンナならではの製品ラインナップ

イタリア生まれのハンナ インストルメンツは、ワインに特化した測定器をご用意しており、日本でも数多くのワイナリー様にご利用いただいています。

pHのほか、酸化防止剤として使用される亜硫酸、滴定酸度、ホルモール態窒素、溶存酸素、還元糖、酒石酸、濁度、糖度、温度など現場での使用に適した製品をラインナップ。

使いやすく、コストパフォーマンスに優れたハンナのワイン測定器をぜひお試しください。

もくじ

オススメ！ハンナの高性能自動滴定装置・・・6

この1台でワイン分析が完了できるプロフェッショナル向け。

省スペース型自動滴定装置・・・8

新型のコンパクト自動滴定装置のご案内。

亜硫酸、滴定酸度、ホルモール態窒素・・・14

亜硫酸、酸度滴定、窒素測定的重要性、簡易型自動滴定器のご案内。

pH・・・16

pHの役割や影響、ハンナのpH計が選ばれるワケなど。

pH、ORP電極のメンテナンス・・・20

信頼性の高い測定には欠かせない電極のメンテナンスガイド。

溶存酸素・・・22

酸素の働きや現場向けの溶存酸素計のご案内。

濁度、還元糖・・・24

現場使用に適したワイン専用の濁度、還元糖の測定器。

酒石酸、糖度・・・26

持ち運びに便利な酒石酸の測定器、簡単に測定できる糖度計。

リンゴ酸・銅・・・28

分光光度計によるリンゴ酸と銅の測定。

温度・・・30

タンクの中をしっかりと測定できる温度計。

試薬・・・31

簡易型自動滴定器の試薬など。



一貫した品質管理

ルーマニアにあるメインの製造工場はISO 9001:2015を認証取得した先進の施設で、100エーカー（40万平方メートル：東京ドーム約8.5個分）という広さを誇ります。ここでは製品の研究／開発からガラス電極の製造、電子部品組立て、最終品質検査まですべてを行い、全製品がCEマーキング（ヨーロッパ地域での法的適合マーク）の認証を受けています。

1つの施設で一貫した品質管理を行うことで最終的に高品質の製品を世界中のお客様にお届けしています。



安心のサポート体制

ハンナ インストルメンツ・ジャパンは1988年の創立以来、日本国内でハンナ製品の販売、サービスを行っております。

近年はお客様に安心してご利用いただけるよう、独自のサービスに注力し、より一層お客様に寄り添ったサポートに取り組んでいます。

- ✓ 製品ご購入後、ユーザー登録をいただいたお客様に対し、ご希望により電話またはメールでのサポートをいたします。
- ✓ 測定器が不調の場合、無償で点検をいたします。
- ✓ 修理・点検等のサービスは国内で行い、スピーディーな対応に努めております。

メーカー校正サービス（有償）

メーカーによる校正と証明書の発行を承ります。

- ✓ メーカー校正対象製品は、pH計・EC計・溶存酸素計・残留塩素計・吸光光度計・濁度計・温度計などです。（※発行可能な書類の種類は、製品によって異なります。）
- ✓ 校正見積書の作成は無償です。ご希望の校正ポイント、必要書類があればご教示ください。
- ✓ 校正作業中は、代替機を無償でお貸し出しいたします。
- ✓ 作業期間は最短約5営業日。（※温度計の校正・JCSS校正などは外注のため、1~2か月お時間をいただく場合がございます。）



【公式キャラクター】
はんなちゃん



QRコードを読み取ると・・・
ハンナのホームページで
製品やサービスに関して
ご覧いただけます！

酒類総合研究所様は、主に研究調査、技術開発支援などを行っており、研究所主催の講演会や、ワイナリー様の研修施設としても有名です。

長年、弊社の亜硫酸測定器/HI 84500をご使用いただき、ランキン法以外にリッパ法での測定もご活用いただいております。

より高精度な亜硫酸測定が可能な自動滴定装置/HI 901Wも評価していただきました。優れた安定性・測定精度をご確認いただき、現在もご使用頂いております。



亜硫酸の分析方法に関して

酒類総合研究所様で取材させて頂いた、分析方法についての内容を一部紹介します。

質問：ランキン法ではどんなメリットとデメリットが考えられますか？

『ランキン法は公定法としても採用されているように、精確な信頼性がメリットと考えます。その反面、分析自体に時間と手間がかかるため、多くの検体を実施するには不向きなのが現状です。』

質問：リッパ法ではどんなメリットとデメリットが考えられますか？

『リッパ法は比較的操作は簡便で多検体の測定に向いていることがメリットと考えます。実際に酒類総合研究所でも、ワイン自動滴定装置(リッパ法)を用いて分析も行っております。リッパ法のデメリットとして、比色法で濃い赤ワインを分析する場合に、滴定終点が判定しづらい点だと考えます。ハンナ様の自動滴定装置/HI 901Wの場合、電位差で終点を判別するため、この点は解消されます。』

酒類総合研究所様では、上記のような評価を頂いております。自動滴定装置ではドージングポンプを採用することで高精度な測定が可能となっており、測定にかかる時間もおよそ1～2分程度です。

(※HI 901Wは販売中止品です。後継機種HI 931/電位差自動滴定装置の詳細は6・7頁をご覧ください。)



QRコードを読み取ると・・・
酒類総合研究所様に取材した
記事を読めます。

世界からも評価され、ワイン愛好家からの注目度も上がっている日本ワイン。北海道から沖縄県まで全国各地で、その産地ごとに個性あるワインが生まれています。

そんな日本ワインを牽引している1人、北海道にある「10Rワイナリー」の醸造家、ブルースさん。

カリフォルニアで醸造コンサルタントとして、ぶどう栽培や醸造方法を指導していましたが、日本のココファームワイナリーとの出会いをきっかけに、醸造指導として来日しました。

醸造技術はもちろん、基本に立ち返った衛生管理も指導され、その結果、2000年の沖縄サミットでは晩餐会のワインに選ばれるなど、国内外から高い評価を受けるまでに成長しています。

そんなブルースさんにお会いしお話を聞いてきました。ブルースさんは「高品質のワイン醸造にはぶどうが大事」と言います。ご自身も「日本のワインは日本のぶどうで」という強い思いから、北海道の岩見沢で2つのぶどう畑を開き、2012年、まだ日本では数少ない受託醸造所の先駆けとして「10Rワイナリー」を立ち上げました。ここでは醸造設備を持たないぶどう栽培農家さんに醸造の場を提供しています。



分析の重要性

10Rワイナリーでは毎年多くのぶどう栽培農家さんや研修生が意見交換をしながら自身のワインを仕込んでいます。ブルースさんはコンサルタントとして、ココファームから変わらない教えの中で分析の重要性も伝えています。

ブルースさん自身も自動滴定装置/HI 901Wを使用しており、「何と云ってもその効率性」「1台で亜硫酸に加え還元糖、揮発酸、YANなどの分析ができる便利さ」「受託醸造として測定サンプルが多く、従来の測定だと時間も手間もかかっていたが、HI 901Wではセットアップ後すぐに測定でき便利」という評価をいただいております。

自分の醸造を見つける

これまで多くのぶどう栽培農家さんや研修生を迎えている中で、ブルースさんは醸造に対して深く介入せず接しているそうです。それは、それぞれが「自分の醸造を見つけることが大事」と語ります。

例えば原料のぶどうの糖度・酸度・pHの分析データがあることで、どんな醸造スタイルにするか、どんな味のワインを目指すのか、自分が造りたいワインが見えてきます。1年、2年、3年とプロセスを繰り返すことで積み上げる経験・知識、分析データを応用することで、セオリーに捉われない自身の醸造スタイルを築き上げることができます。

最後にブルースさんは「日本ワインの品質が向上しているのは、醸造に長く携わっている方の技術の向上が非常に大きい。10Rワイナリーではそういった人材を育成し日本ワインの向上に繋げていきたい」とその想いを語られました。(※HI 901Wは販売中止品です。後継機種HI 931/電位差自動滴定装置の詳細は6・7頁をご覧ください。)



電位差自動滴定装置 HI 931

高精度かつコンパクトな自動滴定装置

HI 931は高い精度・信頼性を備えた自動滴定装置で、電位差滴定のほかpH、mV、ORP、ISE(イオン選択電極)の測定に対応。手動滴定を行われている方はもちろん、買い替えをご検討されている方にもオススメです。

主な特長


- ✓ 独自のビュレットシステムにより、滴定剤と試薬の交換は数秒で完了。通常の25mlビュレットのほか5ml、10ml、50mlビュレットも装着可能。
- ✓ 最大で電極3本、チューブ4本、温度センサー1本をセット可能な電極ホルダーを採用。
- ✓ 角度付きホルダーと調節可能なアーム、取り外し可能なスターラーにより、コンパクトながら高い操作性を実現。
- ✓ 5.7インチカラーディスプレイと一体型の操作ボタン、汚れに強い設計です。



ビュレットの交換はわずか数秒



視認性の良いディスプレイ

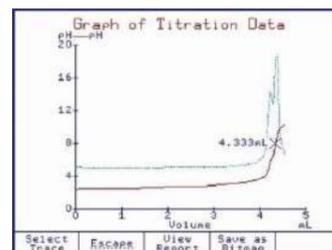

QRコードを読み取ると・・・
製品の詳細ページを
ご覧いただけます！

多様なオプションからセット内容を選定可能！

931-1



SO2セット

※SO2(亜硫酸)測定に適したセット

931-2



TA/YANセット

※TA/YANの連続測定に適したセット

931-3



SO2/TA/YAN
手動切り替えセット

※ビュレットを手動切り替える事で
SO2とTA/YANの測定が可能なセット

931-4



SO2/TA/YAN
自動ポンプ切り替えセット

※2つのポンプで、自動でSO2とTA/YANの
測定切り替えが可能なセット

測定動画



遊離亜硫酸



総亜硫酸



総酸度



ホルモール態窒素



還元糖

品名、品番	電位差自動滴定装置 HI 931
mV	測定範囲：-2000.0~2000.0mV 分解能：0.1mV 精度：±0.1mV オフセットで1点
pH	測定範囲：-2.000~20.000pH 分解能：0.1, 0.01, 0.001pH 精度：±0.001pH 5点校正まで可能(使用可能な標準液はスタンダード8種、カスタム5種)
ISE	測定範囲：1×10 ⁻⁶ ~9.99×10 ¹⁰ 分解能：1, 0.1, 0.01 精度：±0.5%(一価イオン), ±1%(二価イオン) 5点校正まで可能(使用可能な標準液はスタンダード7種、カスタム5種)
温度	測定範囲：-5.0~105.0℃ 分解能：0.1℃ 精度：±0.1℃
滴定の種類	酸塩基滴定(pHまたはmVモード)、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴定、イオン選択性、非水、銀滴定
ビュレット	サイズ：5mL, 10mL, 25mL, 50mL 分解能：0.001mL 吐出量：0.3mL/分~2×ビュレット容量/分で選択可能 精度：±0.005mL(5mLビュレット)、±0.010mL(10mLビュレット)、±0.025mL(25mLビュレット)、±0.050mL(50mLビュレット)

ディスプレイ	5.7インチ グラフィックカラーLCD(バックライト付き)
メソッド数	100種類まで(標準メソッドおよびユーザーメソッド)
スターラー	プロペラ式、回転数：200~2500rpm 分解能：100RPM
データ保存	滴定およびpH/mV/ISEを100データまで保存
使用環境	10~40℃、相対湿度95%以下(保管環境は-20~70℃、相対湿度95%以下)
電源	100-240VAC、50/60Hz
サイズ、重さ	315×205×375mm、約4.3kg(ポンプおよびスターラー1組を含む)
付属品	自動滴定装置本体(アナログボード×1)、ポンプアセンブリ、ビュレットアセンブリ(ビュレットは25mL)、電極ホルダーとスターラー、温度センサー、USBケーブル、USBメモリースティック/インストールキット、電源アダプター、日本語取扱説明書等
価格	オープン (お問合せください)

実用性を重視したシンプルな小自動滴定装置

HI 930は、pH、mV、ORP測定に対応した自動滴定装置です。シンプルな設計で、価格を抑えながらも高精度な測定と操作性を実現。初めて自動滴定装置を導入される方や、コストを重視した更新をご検討の方にもおすすめです。

主な特長

- ✓ 独自のビュレットシステムにより、滴定剤と試薬の交換は数秒で完了。通常の25mlビュレットのほか5ml、10ml、50mlビュレットも装着可能。
- ✓ 最大で電極3本、チューブ4本、温度センサー1本をセット可能な電極ホルダーを採用。
- ✓ 本体にマグネチックスターラーを内蔵しており、設置場所を選ばずコンパクトに収まります。
- ✓ 5.7インチカラーディスプレイと一体型の操作ボタン、汚れに強い設計です。



スターラー一体型で省スペース設計



別売りビュレットホルダー/HI 930160



複数のビュレットユニットを同時に設置できる専用ホルダー。手動切替による測定項目の使い分けを効率化し、試薬の交換ミスも防ぎます。省スペースで安定性にも優れた設計です。

多様なオプションからセット内容を選定可能！



SO2セット

※SO2(亜硫酸)測定に適したセット



TA/YANセット

※TA/YANの連続測定に適したセット



SO2/TA/YAN
手動切り替えセット

※ビュレットを手動切り替える事でSO2とTA/YANの測定が可能なセット



省スペース型 自動滴定装置/HI 930と自動滴定装置/HI 931の主な違い

- ✓ HI 930は上位機種HI 931に比べて価格を抑えた設計で、コストパフォーマンスを重視する現場に適しています。
- ✓ HI 930はスターラー一体型で省スペース。一方のHI931は、取り外し可能なスターラーを採用した設計で、作業環境に応じた柔軟な設置が可能です。
- ✓ HI 930はビュレット1本による手動切替型で、基本的な滴定作業に適しています。HI 931は複数ビュレットの自動切替が可能で、異なる分析項目にも対応可能です。



QRコードを読み取ると・・・
製品の詳細ページを
ご覧いただけます！

品名、品番	電位差自動滴定装置 HI 930
mV	測定範囲：-2000.0~2000.0mV 分解能：0.1mV 精度：±0.1mV オフセットで1点
pH	測定範囲：-2.000~20.000pH 分解能：0.1, 0.01, 0.001pH 精度：±0.001pH 5点校正まで可能(使用可能な標準液はスタンダード8種、カスタム5種)
温度	測定範囲：-5.0~105.0℃ 分解能：0.1℃ 精度：±0.1℃
滴定の種類	酸塩基滴定(pHまたはmVモード)、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴定、非水、銀滴定
ビュレット	サイズ：5mL, 10mL, 25mL, 50mL 分解能：0.001mL 滴下速度：0.01~2.00mL/分 (ビュレット容量により異なる) 最小滴下量：±0.005 mL(5~25mLビュレット)/±0.01 mL(50mLビュレット) 精度：±0.015mL(5~25mLビュレット)、±0.025mL(25mLビュレット)、±0.050mL(50mLビュレット)

ディスプレイ	5.7インチ グラフィックカラーLCD(バックライト付き)
メソッド数	15種類まで (標準メソッドおよびユーザーメソッド)
スターラー	プロペラ式、回転数：200~2500rpm 分解能：100RPM
データ保存	滴定およびpH/mV/を50データまで保存
使用環境	10~40℃、相対湿度95%以下(保管環境は-20~70℃、相対湿度95%以下)
電源	100-240VAC、50/60Hz
サイズ、重さ	315×205×375mm、約3.6kg(25 mLビュレット使用時)
付属品	自動滴定装置本体、ポンプアセンブリ、ビュレットアセンブリ(ビュレットは25mL)、電極ホルダー(アーム付き)、スターラー(一体型)、温度センサー、USBケーブル、USBメモリースティック/インストールキット、電源アダプター、日本語取扱説明書等
価格	オープン (お問合せください)

“亜硫酸測定器 HI 84500”と“自動滴定装置 HI 931”の違い

POINT
01

測定用途・滴定条件



HI 84500



HI 931


HI 84500(亜硫酸測定器)は測定範囲(低濃度・高濃度)に応じて滴定条件が事前設定されていますが、HI 931(自動滴定装置)は滴定剤の種類や濃度、測定条件を用途に応じて設定できるため、濃度領域の測定を1台で効率的に行うことができます。

POINT
02

終点判定精度・表示方法



HI 84500

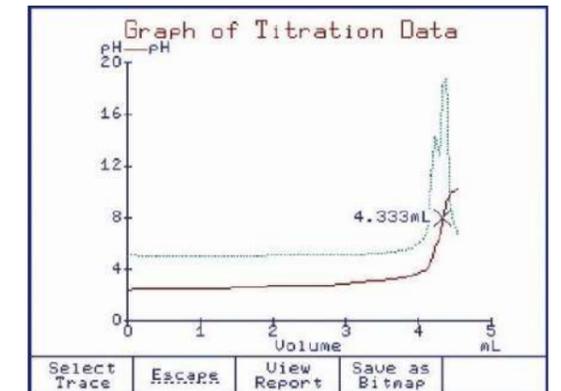

HI 931

リッパ法での亜硫酸測定では、電極の電位反応の安定性と機器本体の処理能力が重要になります。HI 931であれば、電位変化を解析しながら点滴定を行うため、微弱な反応も逃さず、より高精度な亜硫酸測定を実現することが可能です。

POINT
03

攪拌・滴定制御



HI 84500




HI 931


滴定測定では十分な攪拌ができないと数値が不安定になります。HI 931はスクリュー攪拌方式のため、攪拌子の取り出し作業が不要で、測定が簡単です。また、測定前に自動で攪拌を行うプログラムにより、試薬をしっかり反応させてから滴定するため、安定した高精度測定を実現します。

POINT
04

微量滴定制御（最小滴定量）

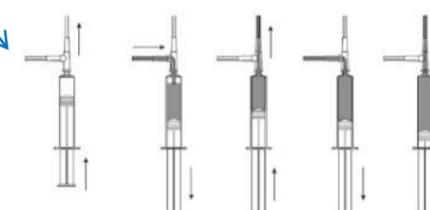

HI 84500

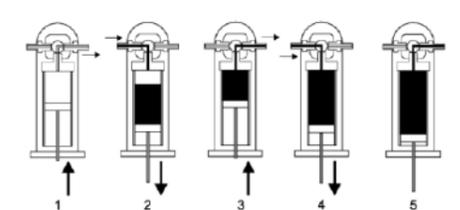

HI 931

HI 84500では亜硫酸測定に必要な滴定量で測定を行うのに対して、HI 931はビュレット容量や測定条件に応じて小数点第三位(0.001mg)まで細かく滴定でき、滴定量を絞る事で正確な検知を行えます。滴定過多で終点を逃してしまうのを防ぎます。

亜硫酸 (SO₂)

亜硫酸の役割と重要性

酸化防止剤として知られる亜硫酸 (SO₂) ですが、近年は無添加ワインなど添加物を使用しないものや限りなく使用量を抑えたワインを目にすることが増えました。添加物を使わない、または限りなく少ないということで興味を持つ消費者も多いはずですが、

とはいえ、世界で見れば必要不可欠と言えるぐらいほとんどのワインには亜硫酸が添加されています。そして、それが人体に悪影響を与えることはないと言われています。(一部の喘息患者を除く)


そんな亜硫酸、ワイン製造においては、

- ✓ **バクテリアや野生酵母の増殖を抑える**
- ✓ **酸化を防止しワインの色や風味、香りなどを安定させる**

などの役割があり、消費者が美味しく飲むための品質管理として重要とされます。

遊離亜硫酸と総亜硫酸

さて、品質を保つために添加される亜硫酸 (SO₂) ですが、添加した量すべてが有効に働くわけでは
ありません。ワインに添加された亜硫酸は糖などと結合するものと結合せずに残るものに分かれます。

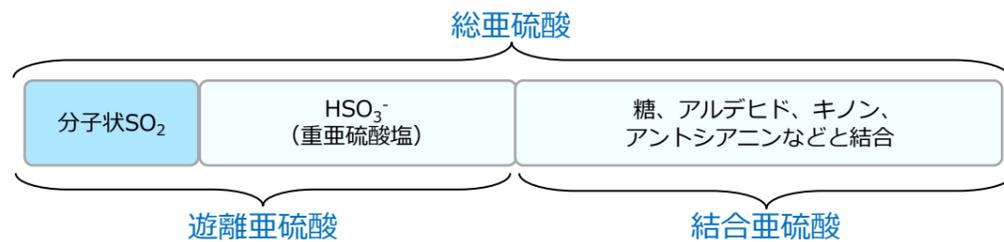

糖などと結合したものが**結合亜硫酸**、結合せずに残ったものが**遊離亜硫酸**。2つを合わせて**総亜硫酸**と呼びます。遊離と結合亜硫酸の割合はワインごとに異なりますが、この中で注目すべきは遊離亜硫酸のうち、分子状SO₂。バクテリアや野生酵母の増殖を抑え、酸化防止に有効なのは主に分子状SO₂です。そして分子状SO₂の量はそのワインのpHに依存します。

遊離亜硫酸とpHの関係

亜硫酸の中で有効に働く分子状SO₂とpHの関係は深く、

ワインのpHが低いほど有効に働く分子状SO₂の割合が高くなる と言えます。

一般的に、0.8ppmの分子状SO₂がバクテリアの増殖や酸化防止に必要と言われます。以下の表は、「0.8ppmの分子状SO₂を維持する時の、ワインのpH値と必要な遊離亜硫酸の量」を示しています。

pH	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
遊離亜硫酸(ppm)	14	18	22	28	35	44	55	69	87	109

同じワインでもpHが0.1異なるだけで必要な遊離亜硫酸の量は変わります。ワイン製造において亜硫酸をどれだけ添加するかは1つの課題です。それは、添加前に存在していた量や結合した量などにもよりますが、ワインのpHを維持・管理することも重要です。(pHに関しては20頁以降)

手動滴定と自動滴定

ランキン法とリッパ法

亜硫酸の測定方法は主にランキン法とリッパ法の2つで、ともに滴定での定量分析です。簡単に言えば、サンプルとなるワインに滴定剤や指示薬を添加し、反応の終点から亜硫酸の濃度を割り出す方法です。終点は色の変化または電極からの応答で判断します。

ハンナの亜硫酸測定器は**リッパ法**です。試薬類もすべて自社製で、滴定剤はヨウ素ではなく標準化されたヨウ素酸塩を採用。試料(ワインサンプル)にヨウ化カリウムを添加した時に、試料中のヨウ素酸塩からヨウ素を形成します。ヨウ素酸塩の滴定剤はヨウ素に比べはるかに安定しています。ヨウ素は紫外線や熱による分解を受けやすく時間経過とともに揮発しますが、ヨウ素酸塩は時間経過による変化が少ないのが特長です。

自動滴定装置のメリット

自動滴定では滴定剤の供給、終点の決定、そして亜硫酸の量を計算する作業を滴定装置が自動で行います。そのメリットは大きく2つです。

- ① **より正確な測定**
- ② **手間や時間の節約**

①より正確な測定

ORP電極を用いて電気化学的に終点を検出することで、主観的な色指示薬より高い精度を発揮。そして、自動滴定システムの心臓部となる精密なドージングポンプ。手動滴定で使うビュレットに比べより正確な量の滴定剤を供給できます。

②手間や時間の節約

手動滴定(ランキン法)でこういった部分でのお悩みなどありませんか？

- ✓ ガラス器具やバーナーの取扱いなど管理が大変
- ✓ 設置スペースを取ってしまう
- ✓ 測定までの準備、時間がかかる
- ✓ 視覚的に判断する不安

手動が自動になれば当然ラクになることは増えますが、品質管理に対する安心感を得られることも大きなメリットです。

ハンナの自動滴定装置のメリット

亜硫酸を測定する自動滴定装置はたくさんありますが、その中でハンナの自動滴定装置は、

- ✓ **コンパクトサイズで省スペース**
- ✓ **ドージングポンプによる精度の高さ & 測定スピードの速さ**
- ✓ **精密な自動滴定装置でありながらコストパフォーマンスの高さ**

が特長です。さらに、

- ・ 滴定装置だけでなく滴定剤などの**消耗品もすべて自社製**
 - ・ ヨーロッパ、アメリカ、南米、オーストラリアなど世界のワインの産地で使用されている**安心と信頼感**
 - ・ 日本国内でのアフターフォローを含めた**サービス体制**
- という点でもご好評をいただいています。

次のページでは数多くのワイナリーで活躍している簡易型自動滴定器をご紹介します！

簡易型 自動滴定器 (亜硫酸用、滴定酸度用、ホルモール態窒素用)

ワイン分析を、もっとシンプルに

SO₂ (亜硫酸) ・ TA (滴定酸) ・ YAN (酵母栄養) の測定に特化した簡易型自動滴定器シリーズ。測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属。初めての方でもすぐに測定を開始できます。また、専用の標準液を使用してポンプ校正を行うことで、信頼性の高さを維持できます。


主な特長

- ✓ 高精度ピストンポンプにより短時間で安定した滴定が可能
- ✓ 測定値は画面表示以外に滴定曲線でも表示可能。必要であればデータ保存とPC転送もできます。
- ✓ SO₂はmV (電位)、TA/YANいずれもpH測定機能を搭載しており、1台2役で活躍します。
- ✓ ティッシュ箱サイズのコンパクト設計で、省スペースに設置可能




※外観例：亜硫酸測定器/HI 84500


測定値をぱっと表示

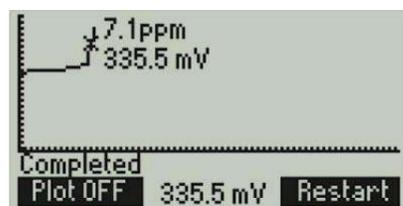

亜硫酸測定器/HI 84500

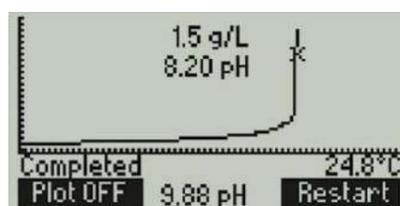

滴定酸度測定器/HI 84502

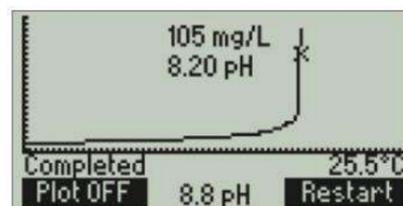

ホルモール態窒素測定器/HI 84533

品名、品番	亜硫酸測定器 HI 84500
測定範囲	低濃度：1.0~40.0ppm(検出単位：0.1ppm) 高濃度：30~400ppm(検出単位：1ppm)
精度@25℃	低濃度：測定値の5%または±0.5ppmのどちらか大きい方 高濃度：測定値の3%または±1ppmのどちらか大きい方
データ保存	SO ₂ ×200データ
測定方法	酸化還元滴定 (リッパ法)
サンプル量	1回の測定に50mL (低濃度、高濃度ともに)
電源	ACアダプター
サイズ、重さ	235×200×150mm 1.9kg
付属品	本体、ORP電極、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、チューブセット、電極内部液、攪拌子、電極洗浄液2種、5mlシリンジ、1mlピペット、ACアダプター、取扱説明書他
価格	350,000円



QRコードを読み取ると・・・
HI 84500の詳細ページをご覧ください！

品名、品番	滴定酸度測定器 HI 84502
測定範囲	低濃度：0.1~5.0g/L 高濃度：4.1~25.0g/L (酒石酸として) ※g/L=ppt、検出単位は低高濃度ともに0.1
精度@25℃	±0.1g/Lもしくは測定値の±3% (どちらか大きい方)
データ保存	滴定で200データ、pHで200データ
測定方法	酸塩基滴定 (7.00もしくは8.20pHでの終点滴定)
サンプル量	低濃度：10mL、高濃度：2mL
電源	ACアダプター
サイズ、重さ	235×200×150mm 1.9kg
付属品	本体、pH電極、温度センサー、テスト用試薬セット、電極内部液、電極洗浄液2回分、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、2000μL自動ピペット、100mlビーカー2個、電源アダプター、取扱説明書他
価格	350,000円



QRコードを読み取ると・・・
HI 84502の詳細ページをご覧ください！

品名、品番	ワイン・果汁用ホルモール態窒素測定器 HI 84533
測定範囲	低濃度：2.14~28.57meq/L、0.21~2.85meq%、30.0~400.0mg/L 高濃度：21.7~71.4meq/L、2.14~7.14meq%、300~1000mg/L
精度@25℃	±0.1mg/Lもしくは測定値の3% (どちらか大きい方)
データ保存	滴定で200データ、pHで200データ
測定方法	酸塩基滴定 (終点はpH8.0~8.5で調整可能)
サンプル量	低濃度：10mL、高濃度：5mL
電源	ACアダプター
サイズ、重さ	235×200×150mm 1.9kg
付属品	本体、pH電極、温度センサー、テスト用試薬セット、電極内部液、電極洗浄液2回分、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、2000μL自動ピペット、100mlビーカー2個、電源アダプター、取扱説明書他
価格	350,000円



QRコードを読み取ると・・・
HI 84533の詳細ページをご覧ください！

※試薬は31頁を、製品の詳細はホームページをご覧ください。「ハンナジャパン」で検索

ワインとpH

pHは酸性/アルカリ性の度合いを示し、ワイン製造においては最も重要な分析項目の1つです。pH測定は発酵、熟成、清澄(せいちょう)、安定化、瓶詰めなどの多くの工程に影響を与えます。多くのワインはpH3~4の間にあり、pH値が高いと腐敗のリスクが高くなります。(pH3.6未満だと細菌の増殖や酸化の影響が少なくなります)



ワインのpHはどれくらい？

白ワイン：発酵前のブドウ果汁だとpH3.3未満、完成品は3.0~3.3。
赤ワイン：発酵前のブドウ果汁だとpH3.4未満、完成品は3.3~3.5。

pHの役割、影響

では、具体的にpHはどうワインに影響するのでしょうか？

- ✓ **微生物安定性**：微生物の成長を抑制することで腐敗を防止。
- ✓ **亜硫酸 (SO₂)**：腐敗から守るためのSO₂の効果を高めます。
- ✓ **マロラクティック発酵**：マロラクティック細菌のリンゴ酸から乳酸への転換に影響。
- ✓ **タンパク質の安定性**：ヘイズ形成とその処理において役割を果たします。
- ✓ **感覚**：見た目、香り、味に影響。

pHと酸度の違い

pHと酸度を一言で説明すると以下の通りです。

pH：水素イオン活性を測定し、酸性/アルカリ性の度合いを示します。pH電極を用いて測定。

酸度：ワイン中の酸の濃度を示し、滴定で検出。

pHが低ければ(酸性側) その分酸度が高いと思われるかもしれませんが、単純にそうとは言えません。例) ワインに酸を添加し酸度を高めてもpHにさほど影響しないこともあります。それはフェノールや他の酸が存在し緩衝作用が働くためです。

酒石酸などでpH調整を行う場合には、pHと酸度の関係を知るためにもワインの調整の前後でそれらを測定することは大切です。

ワイン専用であること

ハンナではワイン測定を目的とした専用のpH計をご用意しており、主に3つの特長があります。

①特殊なpH電極を採用

ワインや発酵前のブドウ果汁は固形分が多く、一般的なセラミック製の液絡部だと詰まりやすくなります。結果、pH電極の消耗・劣化が促進されます。ハンナはPTFEスリーブとともにガラスのすり合わせの多孔性を利用した、独自の詰まり予防システムを採用。スリーブが固形物の流入を防ぐ一方で、ガラスの合わせめから内部液が適切に流出。そのため測定の安定性がアップし、かつ消耗・劣化を最小限に抑えます。

②pH7とpH3での校正

ワインのpHに近いポイントでの校正を行うことで高い精度と信頼性を保持。

③自社製のメンテナンス品

pH標準液はもちろん、電極のメンテナンスに使用する洗浄液や保存液、内部液などもすべて自社製なので安心。



ワイン測定のためのスリーブ式pH電極



品名、品番	HALO2 ワイン用ワイヤレスpHテスター HI 9810332	ワイン用pHテスター HI 981033
測定範囲	pH : 0.00~12.00pH (本体表示は-2~16pHまで) mV : ※Hanna Labアプリ使用時に可能 温度0.0~60.0℃	pH : 0.00~12.00pH (本体表示は-2~16pHまで)
精度@25℃	pH : ±0.05pH 温度 : ±0.5℃	±0.05pH
pH校正	自動で1点、2点、3点または4点校正* (pH 1.68 *, 3.00, 7.01, 10.01またはpH 1.68 *, 3.00, 6.86, 9.18の組み合わせから標準液を自動で認識) * Hanna Labアプリ使用時に可能	自動で1点または2点 (pH7.01とpH3.00の2点)
温度補償機能	自動または手動	-
電源	CR2032ボタン電池 1個 (約1000時間の継続使用が可能、Bluetoothの使用だと約500時間)	CR2032ボタン電池 1個 (約1000時間の継続使用が可能)
サイズ、重さ	長さ206mm×幅51mm×厚さ21mm 50g	長さ157×幅51×厚さ21mm 46g
付属品	本体 (pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液 (13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他	本体 (pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液 (13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他
価格	32,000円	29,000円
Bluetooth	Bluetooth®4.0	-



※専用のアプリ「Hanna Lab」は無料で課金はありませぬ
※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

QRコードを読み取ると・・・
製品の詳細ページを
ご覧いただけます！



HI 9810332



HI 981033

pH



HI 2020-01 (pH・EC・DO)



HI 2002-01 (pHのみ)



HI 99111D (pH)



電極ホルダー付きのスターラーを組み合わせれば卓上で使用も可能。
HI 181 : 36,000円

世界初、タブレット型の測定器 edge®

- ✓ スタイリッシュなカッコよさだけじゃありません。性能の高さも兼備しています。
- ✓ 品質管理にぴったりの高い精度と信頼性。
- ✓ 卓上型のほか設置スペースゼロの壁掛け式、持ち運びも可能で使い方いろいろ。
- ✓ pH電極の状態を画面上で確認できる安心の機能。
- ✓ pHだけでなくDO (溶存酸素)やEC (導電率)の測定も可能。(黒いボディの方)
- ✓ 必要であればデータの保存と転送も可能。(USBメモリーへ、または直接PC接続)

デザイン、精度・性能、コストパフォーマンスに優れています。

ワイン用電極が付属のセットもございます。

HI 2020-01W (pH・EC・DO)
HI 2002-01W (pHのみ)

コンパクトな防水タイプ

- ✓ 本体はIP67の防水型で安心。
- ✓ ワイン用のpH電極が標準付属。
- ✓ pH電極の状態を画面上で確認できる安心の機能。
- ✓ 片手で持ちやすいすっきりとしたデザイン。
- ✓ 見やすい画面にボタン2つの簡単操作。

品名	edge (エッジ)	
品番	HI 2020-01 (黒いボディのpHキット)	HI 2002-01 (白いボディのpH専用器)
測定範囲	ワイン用pH電極使用時：0~12.00pH、0~12.000pH (本体表示は-2~16pHまで) pH-mV : ±1000.0mV 温度0~80℃ (本体表示は-20~120℃まで)	
精度@25℃	±0.01pH、±0.002pH pH-mV : ±0.2mV 温度 : ±0.5℃	
pH校正	ワイン用pH電極ではpH7.01とpH3.00の2点 (本体は5点校正まで可能)	
その他	温度補償機能、自動電源オフ、データの保存と転送、防水機能はありません	
電源	充電式 (卓上型と壁掛け式では電源ケーブルを接続すれば継続使用が可能)	
サイズ、重さ	長さ202×幅140×厚さ12.7mm 250g	
付属品	本体、pH電極(一般用)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、電極洗浄液2袋、初回分標準液(pH4.01、7.01、10.01各2袋)、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他	
価格	115,000円	98,000円
pH電極	ワイン用のHI 10480を推奨 (58,000円)	




QRコードを読み取ると・・・
製品の詳細ページを
ご覧いただけます！

品名、品番	ポータブルワイン用pH計 HI 99111D
測定範囲	0~12.00pH (本体表示は-2~16pHまで) pH-mV : ±825mV 温度0~80℃ (本体表示は-5~105℃まで)
精度@25℃	±0.02pH pH-mV : ±1mV 温度 : ±0.5℃ (60℃まで)、±1℃ (60℃以上)
pH校正	自動で1点または2点 (pH7.01とpH3.00の2点)
その他	温度補償機能、自動電源オフ
電源	単四アルカリ電池 3本 (約1400時間の継続使用が可能)
サイズ、重さ	長さ154 x 幅63 x 厚さ30mm 196g
付属品	本体、pH電極(ワイン用)、pH3.00&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
価格	115,000円
交換電極	ワイン用pH電極 FC 10483 : 55,000円



QRコードを読み取ると・・・
製品の詳細ページを
ご覧いただけます！

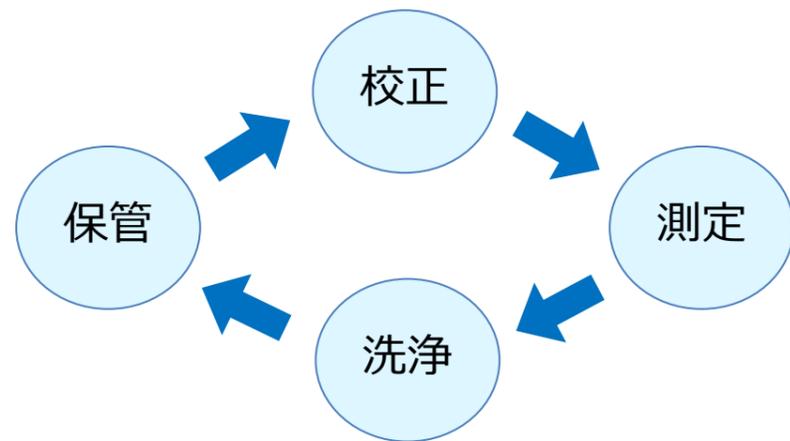

- ✓ **校正** 数値のわかっている標準液を使用し測定器の数値のズレを正す作業。信頼性の高いpH測定を行うためにも、定期的に校正を行いましょう。
- ✓ **洗浄** ワインは残留物(不純物)が多いため、測定時に電極の液絡部が詰まりやすいです。専用の電極洗浄液で残留物を除去することが大切です。
- ✓ **保管** 電極先端部は乾燥状態が続くと劣化してしまいます。電極保存液を使い保管することで乾燥状態を防ぎ電極の状態を保ってあげます。

校正

ハンナのワイン用pH計ではpH7とpH3の標準液で校正します。ワインのpH値に近いpH3の標準液を使うことで、精度と信頼性を高めます。ボトルタイプは開封後3ヶ月以内の期限となるため、測定頻度が高くない方には使い切りの袋タイプがオススメ！常にフレッシュな状態で使用できます。
※ORP電極はチェック液を使用して数値の検証をます。校正(ズレを正す)は行えません。

pH標準液(500mLボトル)		
品番	標準液値	価格
HI 5003	pH3.00	6,600円
HI 7007L	pH7.01	3,000円
使い切りの袋入り(20mL×25袋)		
HI 50003-02	pH3.00	9,500円
HI 70007P	pH7.01	7,200円

ORPチェック液(500mLボトル)		
品番	溶液値	価格
HI 7021L	240±50mV	各7,000円
HI 7022L	470±50mV	

pH校正やORPチェックは毎回行うのがベストですが、以下は目安です。
✓ 毎日や週3日以上測定する場合には、**少なくとも1週間に1回を推奨**
✓ 週1回や月に数回測定する場合には、**使用する日の測定前に行うことを推奨**

袋入りタイプの使用方法



洗浄

pH、ORP電極を使用していて「**校正ができない**」「**測定値が安定しない**」ということはありませんか？その一番の原因は電極の消耗・劣化によるもので、ブドウ果汁やワイン中の残留物(不純物)が影響します。ワインの測定では適切な洗浄がとっても大切です。

水洗いじゃダメなの？適切な洗浄方法とは？

通常、精製水(水道水)で洗い流しますが、週に1回を目安に測定後に電極洗浄液をご使用ください。電極洗浄液は強い洗浄力を持ち、水洗いだけでは落とし切れない汚れや付着物を除去します。これにより電極の消耗・劣化を最小限に抑えることができます！使用方法は、ワイン専用の電極洗浄液にpH/ORP電極を15分間浸け置きするだけです。

電極洗浄液(ワインの沈着物の除去用)		
品番	容量	価格
HI 70635L	500ml(ボトル)	7,700円
HI 700635P	20mL×25袋	8,700円

ボトルは開封後1年間の有効期限ですが、少しずつ劣化し効力が落ちるため袋入りがおススメ！
1回使い切りで未使用なら数年先までの期限です。



保管

洗浄が終わったら保管です。pH、ORP電極は長く乾燥させてしまうと劣化の原因となり、校正や測定が行えなくなります。使用後は電極保存液を使用して保管しましょう！電極保護キャップに少量の電極保存液を入れキャップをすることで湿った状態を保てます。

精製水や水道水に浸けて保管するのはダメなの？

pH/ORP電極は専用の電極保存液以外(精製水や純水、水道水など)に浸けての保管は避けてください。これらに長時間浸けると浸透圧により電極内部液への侵入、また内部液の浸出により反応が遅くなる原因となります。電極保存液は電極内部液に限りなく近い成分のため安心です！

電極保存液		
品番	容量	価格
HI 70300L	500mL	3,300円
HI 70300M	230mL	3,100円
HI 70300S	30mL	2,200円



密閉式電極保護キャップは上部(緑色)をきゅっと締めることができ、限りなく密閉の状態にできます。
※電極保存液は無色で、写真右のピンク色はイメージです。



pH標準液や洗浄液、保存液などのページをご覧ください。

ワインと酸素

ワインを良質なものにするために重要な働きをしているのが酵母です。酵母は糖からアルコールや炭酸ガス（二酸化炭素）を作り出します。

酸素は酵母の増殖を促進するため、発酵時には良い役割を担います。ワイン中の溶存酸素や添加する酸素量を管理・調整することは、ワインの風味や色など品質管理につながります。

【酸素が足りない場合に起こり得ること】

- ✓ 酵母の増殖の低迷
- ✓ 発酵期間の長期化
- ✓ 残糖量の多量化
- ✓ アセトアルデヒドの増加

【酸素が影響するワインの品質】

- ✓ 酵母の発酵促進
- ✓ ワインの良質な色
- ✓ 香りや味



酸素添加はタイミングが重要

酸素は酵母の増殖を促進するために重要ではありますが、それは発酵時に限ります。酸素は酸化の原因にもなり、瓶詰めおよび熟成の間などにおいては有害となり、製造工程の後半は最小限に抑える必要があります。（瓶詰め前には0.5ppmより少ないことが望ましいとも言われます）

そのため、ワイン製造においては各工程での溶存酸素の測定・管理が大切になります。



次のページでは人気の溶存酸素計をご紹介します！



HI 2040-01 (DO・pH・EC)

HI 2004-01 (DOのみ)

品質管理にぴったり！

- ✓ タブレット型でカッコよく、かつ品質管理向けの高い精度と信頼性。
- ✓ 卓上型のほか設置スペースゼロの壁掛け式、持ち運びも可能で使い方がいろいろ。
- ✓ 扱いやすい直径12mmの細径電極。
- ✓ DOだけでなくpHやEC（導電率）の測定も可能。（黒いボディの方）
- ✓ 必要であればデータの保存と転送も可能。（USBメモリーへ、または直接PC接続）

デザイン、精度・性能、コストパフォーマンスに優れています。

品名	edge (エッジ)	
品番	HI 2040-01 (黒いボディのDOキット)	HI 2004-01 (白いボディのDO専用器)
測定範囲 (検出単位)	溶存酸素：0.00~45.00ppm (0.01ppm)、酸素飽和度：0.0~300.0% (0.1%) 温度0~50℃ (本体表示は-20~120℃まで)	
精度@25℃	測定値の±1.5% ±1digit	温度：±0.5℃
校正	1点または2点校正 (0%：HI 7040標準液を使用、100%：空気校正)	
その他	温度/塩分/高度補正機能、自動電源オフ、データの保存と転送、防水機能はありません	
電源	充電式 (卓上型と壁掛け式では電源ケーブルを接続すれば継続使用が可能)	
サイズ、重さ	長さ202×幅140×厚さ12.7mm	250g
付属品	本体、DO電極、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、電極電解液 (30mL)、メンブロンキャップ/Oリング各2個、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他	
価格	167,000円	155,000円



QRコードを読み取ると・・・
製品の詳細ページを
ご覧いただけます！



付属品がケースに収納されており便利です



還元糖の測定には試験管ヒーターが必要です。

濁度とベントナイトを測定！

主に白ワインは瓶詰め前に安定化させることがあります。その際、ベントナイトを添加しタンパク質を除去することでワインの透明度と安定性を向上させますが、タンニンの減少や色味の影響などマイナス面もあります。

HI 83749は1台で濁度とベントナイトの量を把握できます。

主な特長

- ✓ 精度の高さに加え校正機能もあり信頼性を常に維持できます。
- ✓ 購入時の付属品も充実しており安心。

ワイン中の還元糖を測定！

ブドウを主原料とするワイン中の主要な糖成分はグルコースとフルクトースで、還元糖として知られています。本器は専用のフェーリング試薬を使用することで、手軽に現場でのチェックが行えます。ご購入時には初回分の試薬(約20回分)など必要なものがすべてセットになっており、安心です。



専用のフェーリング試薬

品名/品番	ワイン用濁度計/ HI 83749
測定範囲	0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU
精度@25℃	測定値の±2%+0.05NTU
校正	2点、3点、または4点校正(専用バリデーターにて)
その他	データの保存(200データ)とPC転送(RS232もしくはUSBケーブル)
電源	単三アルカリ電池4個またはACアダプター
サイズ、重さ	長さ224×幅87×厚さ77mm 512g
付属品	測定用ガラスセル6組、バリデーターセット、ベントチェック液、シリコンオイル、タグ5個、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面洗浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他
価格	270,000円



QRコードを読み取ると・・・
製品の詳細ページを
ご覧いただけます！

品名/品番	ワイン用還元糖測定器/ HI 83746
測定範囲	0.00~50.00 g/L(ppt) 検出単位: 0.25 g/L
精度@25℃	±0.50g/L ±測定値の5%
電源	単三アルカリ電池4個またはACアダプター
サイズ、重さ	長さ224×幅87×厚さ77mm 512g
付属品	測定用ガラスセル4組、試薬セット20回分、活性炭(HI93703-59)、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル面洗浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他
価格	220,000円
試薬	HI 83746-20 (20回分) : 14,500円
試験管ヒーター	HI 83980N : 270,000円



QRコードを読み取ると・・・
製品の詳細ページを
ご覧いただけます！



付属品がケースに収納されており便利です

酒石酸を測定！

酒石酸はワインの酸度を左右する重要な酸として重要視されます。本器では専用の試薬を使用することで、手軽に現場でのチェックが行えます。ご購入時には初回分の試薬（約5回分）など必要なものがセットになっています。



ハンナでは試薬もすべて自社製なので安心です。

手軽に！素早く！2ステップ！



数滴垂らしてボタンを押すだけ！

ワイン用デジタル屈折計

HI 96813は屈折率を測定し糖度と潜在的アルコール度[※]に換算します。（※糖とアルコールの関係に基づき完成したワインのアルコール度を推定したもの）糖からアルコールの転換は様々な要因が関係し一般的には決まった換算方法はありません。しかし、ハンナは長年の経験によりアルコール度を推定する機能を備えた本器を開発しました。（ただし非発酵性の糖や蒸留したものは対象外）

HI 96814は糖度を% Brix、エクスレ、KMWの3種類で表示可能です。エクスレ(°Oe)とは比重に基づき主にドイツ、スイス、ルクセンブルクのワイン産業において果汁の糖分測定のために用いられます。KMW(°KMW)は主にオーストリアで果汁の糖分測定のために用いられ、°Baboとしても知られています。1°KMWはおおよそ1% Brixまたは5°Oeに等しくなります。

品名/品番	ワイン用酒石酸測定器/ HI 83748
測定範囲	0.0~5.0 g/L(ppt) 検出単位：0.1 g/L
精度	±0.1 g/L @2.0 g/L
電源	単三アルカリ電池4個またはACアダプター
サイズ、重さ	長さ224×幅87×厚さ77mm 512g
付属品	測定用ガラスセル2組、初回分試薬（5回分）、200μL自動ピペット、5mLシリンジ、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他
価格	160,000円
試薬	HI 83748-20（20回分）：16,500円

品名 品番	ワイン用デジタル屈折計	
	HI 96813	HI 96814
測定範囲 (検出単位)	0.0~50.0% Brix (0.1% Brix) 0.0~25.0% v/v (0.1% v/v) 0.0~80.0°C (0.1°C)	0.0~50.0% Brix (0.1% Brix) 0~230°Oe (1°Oe) 0.0~42.0°KMW (0.1°KMW) 0.0~80.0°C (0.1°C)
精度@25°C	±0.2% Brix、±0.2% v/v、±0.3°C	±0.2% Brix、±1°Oe、±0.2°KMW、±0.3°C
測定時間	約1.5秒 測定必要量：約2滴	
その他	校正：水（蒸留水、精製水） 温度補償：自動（10~40°C）	
電源	9Vアルカリ電池1個（約5000回の測定が可能）	
サイズ、重さ	長さ192×幅102×厚さ67mm 420g	
付属品	本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書他	
価格	58,000円	58,000円



QRコードを読み取ると・・・
製品の詳細ページを
ご覧いただけます！

～リンゴ酸と銅の測定に～



リンゴ酸の測定が可能

滴定法では測定する事が出来ない、リンゴ酸だけの測定が可能です。
※他社製試薬を使用する必要があります。

優れた操作性

操作性に優れたキーパッドはラテックス手袋着用時でも反応。電源も電源アダプターのほか、充電式バッテリーも内蔵。フル充電で約8時間持ち、安心です。

ワイン中の銅を測定

ぶどう栽培における、農薬散布により銅が果汁内に残ってしまいます。
ハンナ製の試薬を使用し銅測定を行います。

スプリットビーム方式

心臓部となる光学部は高品質かつ計算されたデザインにより高精度の測定を可能にします。光学システムにはビームスプリッターとリファレンス検出器を内蔵。迷光を最小に抑えることで吸光度測定の誤差を減少させ、かつ光源の強さを常に監視しどんな変化にも自動で補正します。

少ない手間で簡単

光源にはエネルギー効率の高いタングステンハロゲンランプを採用。ランプは測定時のみ作動するため点灯時間を抑え長寿命。交換の頻度とコストを低く抑えられます。さらに光源ランプはお客様自身で簡単に交換可能。本体にセットするだけの状態になっているため時間や手間を省けます。もちろん交換後の光源の調整も心配いりません。

自動検証機能

電源を入れると光源の内部チェックと回析格子(グレーティング)の位置を校正し波長の確認を行います。もし内部に問題がある場合には画面上でお知らせしますので安心です。ウォームアップの必要もありません。



QRコードを読み取ると・・・
製品の詳細ページを
ご覧いただけます！



このカタログ (A4サイズ) に納まる設置スペースで、高さも350mlの缶より少し高いほどのコンパクトさ。



【バイアルバーコードリーダー】

バイアルを入れるだけでメソッドの種類を自動認識できるようになりました。



【バイアルローテーション】

バイアルを回転させ何度も読み取ることで測定精度を最大限高めました。



【340～900nmの波長をカバー】

100近い内蔵メソッドに加え、カスタムメソッドの作成も可能。1nm範囲での波長変更ができます。

品名/品番	iris2 (アイリス) / HI 802
波長レンジ	340 - 900nm 分解能: 1nm 波長精度: ±1.5nm
吸光度レンジ	0.000 - 3.000Abs 吸光度精度: 5mAbs (0.000 - 0.500Abs) 、1% (0.500 - 3.000Abs)
測定モード	透過率(%T)、吸光度(abs)、以下の単位での濃度 (ppm、mg/L、ppt、°f、°e、ppb、meq/L、µg/L、PCU、Pfund、pH、dKH、°dH、meq/kg) および測定単位なし
光学システム、光源	スプリットビーム方式、タングステンハロゲンランプ
スペクトルバンド幅	5nm 迷光: 0.1%T未満@340nm (NaNO ₂)
サンプルセル	10mm(角型)、50mm(角型)、16mm(丸型)、22mm(丸型)、13mm(丸型)の5種類に対応
メソッド数	メーカー設定: 150項目まで (うち106項目はインストール済)、ユーザー設定: 100項目まで
データ保存、転送	9999データまで保存可能、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
データ転送	本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 (csv、PDFファイルでの転送が可能)
電源	電源アダプターおよび内蔵Li-ion充電式バッテリー (フル充電で約8時間または約3000回の測定)
サイズ、重さ	幅155×高さ205×奥行322mm 3.0kg
価格	オープン

簡単小型



HI 98501

投げ込み式
3mケーブル



HI 98539

醸造向けの1mセンサー



HI 935012

ハンナの温度計は精度が高く安心です！

酵母は温度が低いと動きが鈍くなり、高温では死滅します。発酵温度については議論がありますが、白ワインは低温（7～15℃）だとフルーティーになると言われます。一方、赤ワインはより高い温度（20～30℃）だとタンニンと色の抽出が良好になります。また、温度管理は瓶詰め前のワインの調整と保管時でも重要です。赤ワインは20℃で、白ワインは15℃で調整されます。

HI 935012はタンク内の温度測定にぴったり！1mのステンレス製センサーは深いところや異なる場所をしっかりと測定できます。専用のケース付きなので保管もラクチン。HI 98539は3mケーブルで、おもり付きのセンサーを投げ込んで使います。HI 98501は片手で持てるハンディタイプです。

品名/品番	醸造向け温度計/ HI 935012	投げ込み式温度計/ HI 98539	温度テスター/ HI 98501
測定範囲 (検出単位)	-20.0～120.0℃ (0.1℃)	-20.0～80.0℃ (0.1℃)	-50.0～150.0℃ (0.1℃)
精度	本体：±0.1℃ 電極精度：±0.3℃ (-10.0～80.0℃)、±0.7℃ (それ以外)	±0.3℃	±0.2℃ (-30.0～120.0℃)、 ±0.3℃ (それ以外)
使用環境	-20～50℃ (相対湿度100%以下)	-30～50℃ (相対湿度100%以下)	
防水		IP65	
電源	単四アルカリ電池3個	単四アルカリ電池3個	CR2032ボタン電池1個
サイズ、重さ	長さ140×幅57×厚さ28mm 175g	長さ107×幅59×厚さ17mm (本体部分のみ) 150g	長さ70×幅50×厚さ22mm (本体部分のみ) 50g
付属品	温度センサー、衝撃防止用ラバーブーツ、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他	単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他	先端部保護キャップ、CR2032ボタン電池1個、日本語取扱説明書他
価格	47,000円	21,000円	11,000円



QRコードを読み取ると・・・
製品の詳細ページを
ご覧いただけます！

HI 901w

品番	品名	価格	備考	毒劇
HI 70456	0.1N水酸化ナトリウム滴定剤	4,700円	TA,YAN, 揮発酸用	
HI 70440	0.02Nヨウ素滴定剤	12,800円	亜硫酸用	
HI 70444	25%硫酸	8,500円	亜硫酸用	劇
HI 70404	安定剤100袋	5,500円	亜硫酸用	
HI 70435	5M水酸化ナトリウム (総亜硫酸時のみ)	6,200円	亜硫酸用	劇

HI 84500 (亜硫酸)

品番	品名	価格	毒劇
HI 84500-50	低濃度滴定剤230mL	6,500円	
HI 84500-51	高濃度滴定剤230mL	6,500円	
HI 84500-55	校正用標準液120mL	10,000円	
HI 84500-60	酸性試薬230mL	7,200円	劇
HI 84500-61	アルカリ試薬120mL	7,200円	劇
HI 84500-62	安定剤100回分	7,200円	
HI 7021L	ORPチェック液240mV±50mV	7,000円	
HI 3148B	ガラスボディORP電極、1mケーブル	68,000円	



HI 84502 (滴定酸度)

品番	品名	価格
HI 84502-50	滴定剤230mL	6,200円
HI 84502-55	校正用標準液120mL	10,000円
HI 70082M	pH8.20標準液230mL	4,500円
HI 1048B	pHガラス電極 (1mケーブル付)	58,000円

HI 84533 (ホルモール態窒素)

品番	品名	価格	毒劇
HI 84533-50	滴定剤230mL	9,000円	
HI 84533-55	校正用標準液120mL	9,000円	
HI 84533-60	ホルモール過酸化水素試薬30mL	9,000円	劇
HI 84533-61	ホルモール塩基試薬230mL	9,000円	劇
HI 84533-62	pH調整剤30mL	9,000円	
HI 70082M	pH8.20標準液230mL	4,500円	
HI 1131B	pHガラス電極 (1mケーブル付)	39,000円	



※上記以外のものはホームページをご覧ください。「ハンナジャパン」で検索